


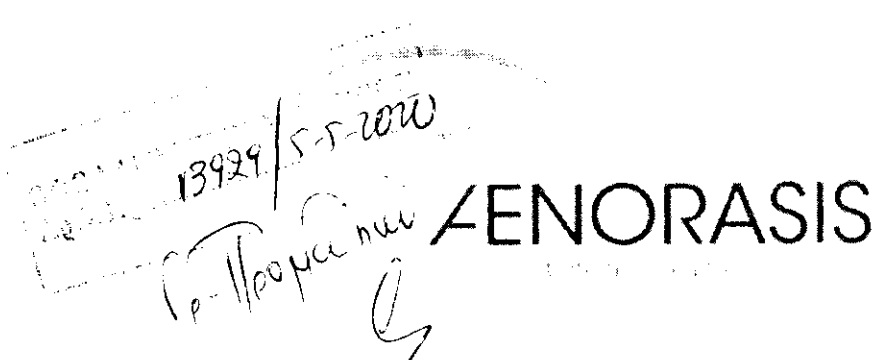

ΠΡΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Μελίσσια, 29 Απριλίου 2020

Θέμα: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλινικών Προϊόντων Μικρής Αξίας CPV 33698000-9».

Κύριοι,

Αναφερόμενοι στο υπ' αριθμ. πρωτ. 12115 αίτημα του Νοσοκομείου σας, υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για την διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλινικών Προϊόντων Μικρής Αξίας CPV 33698000-9».

Με εκτίμηση,

Για την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧ/ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΙ 17 & Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
15127 Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 15127 - ΤΗΛ. 210 6136332
ΑΦΜ: 094503580 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40693/01ΑΤ/Β/98/156
Α.Μ.Π. 1272 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 002926501000

Σωτηριος Κωνσταντάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Email tenders@enorasis.gr, ΤΗΛ. 210 6136332, FAX 210 8105298

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ

Email orderentry@enorasis.gr, ΤΗΛ. 210 6138139, FAX 210 6136345

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου 15127 Μελίσσια Αττικής
Τ. 210 6136332, F. 210 8105298, <http://www.enorasis.com>



ΑΕΝΟΡΑΣΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣΜΟΥ

A/A 28

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΡΟΥ:

Με ροόμετρο μαλακό, αεραγωγό με πώμα, κλείστρο ροής, συνδετικό Y και σύνδεση luer lock, μήκος πάνω από 1,5 μ.

Η πρότασή μας:

Συσκευή χορήγησης ορών και υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων σε μεγαλοσταγόνες.

Η συσκευή να διαθέτει:

1. Ανθεκτικό διατηρητικό ρύγχος με κάλυμμα και αεραγωγό φίλτρο με πώμα
2. Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml = 20 σταγόνες)
3. Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15 μm στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου
4. Κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής
5. Αξιόπιστο ρυθμιστή ροής, ρυθμίζεται εύκολα και δεν μεταβάλλεται η θέση του κατά τη χορήγηση
6. Πλάγια προδιατηρημένη διακλάδωση τύπου "Y" για επείγουσες χορηγήσεις
7. Σωλήνα διαφανή ευρέως αυλού που να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα χωρίς διαρροές και χωρίς να μεταδίδονται οι κινήσεις της συσκευής ορού στον καθετήρα
8. Τελικό άκρο σωλήνα με πώμα αεραγωγό φίλτρο, που διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεών της
9. Μήκος > 200 cm για μεγαλύτερη ευχρηστία και μείωση κινδύνου από μετακίνησης του φλεβοκαθετήρα από τις κινήσεις του ασθενούς
10. Όγκος εξαέρωσης < 15 ml για ελάχιστη απώλεια διαλυμάτων/φαρμάκων
11. Να είναι μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE)
12. Να διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα και να φέρει CE

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧ/ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 & Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 151 27 - ΤΗΛ. 210 6136332
ΑΦΜ: 094503580 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ.Μ. Α.Ε.: 40653/01ΑΤ/Β/98/156
Α.Μ.Π. 1272 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002926501000

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου 151 27 Μελίσσια, Αθήνα
Τ. 210 6136332, F. 210 8105298, <http://www.aenorasis.com>

